


ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo nº: PE 63/2019 UASG 150247 2020 800099
MOGAMI

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	Nº DA FOLHA
1. Capa do Processo	✓		
2. Lista de Verificação	✓		1
3. Termo de abertura	✓		2
4. DIEx do setor requisitante	✓		3,4,5,6
5. Requisição	✓		7,8,9
6. Pedido de autorização para empresa	✓		10
7. Autorização da empresa	✓		11
8. Solicitação de adesão para UASG	✓		12
9. Aceite da UASG	✓		13
10. Cópia da Ata de Registro de Preço	✓		15,16,17
11. Cópia do Edital da Licitação (SFC)		✓	
12. Cópia do Termo de Referência (SFC)		✓	
13. Cópia do Parecer Jurídico da CJU da UASG (SFC)		✓	
14. Pesquisa de preço	✓		18,19,20,21,22
15. Declaração SICAF	✓		23,24
16. Declaração CADIN	✓		25
17. Declaração CEIS	✓		26
18. Declaração TCU	✓		27
19. Nota de empenho	✓		28,29
20. Termo de encerramento	✓		30

OBS: No mesmo dia da emissão da nota de empenho, deverá ANTES ser consultadas e impressas as declarações (SICAF, CADIN, CEIS e TCU).


GERSON PAES DE ALMEIDA – Cap R/1
 Respondendo pela Chefia da SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



Pregão Eletrônico Nr.63/2019 – UASG 150247


TERMO DE ABERTURA

Em conformidade com o disposto no Artigo 38 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, faço a abertura do Processo Administrativo acima citado cujo objeto está definido na Autorização do Ordenador de Despesas.

Rio de Janeiro - RJ, 03 de fevereiro de 2020.

Fabiola A. B. de Souza Sestare

FABIOLA APARECIDA BENTO DE SOUZA SESTARE – 3º SGT
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CML - 1ª RM

HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

DIEX Nº 276 - Set Mat/Div Adm/HGeRJ

O NUP: 65344.004603/2019-53

Rio de Janeiro, RJ, 08 de Dezembro de 2019

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de Material de Esterilização (CME) por Adesão em Ata de Registro de Preço (Carona).


1. Solicito – vos providências, nos termos do contido na Lei 8.666/1993, na IG 12 – 02 no sentido de adquirir o material descrito abaixo, conta contábil 33.90.30.36.

2. A aquisição é necessária para uso na esterilizadora STERRAD, por período de (03 três) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade
1	Cassete de peróxido de hidrogênio. Os cassetes contêm 10 ampolas plásticas internas. Cada ampola possui 1,8 ml de peróxido de hidrogênio a 58% cada ampola. A conformação do cassete permite a injeção automática do agente esterilizante no equipamento, bem como a leitura óptica a fim de verificar a validade do mesmo. Cada cassete é embalado individualmente permitindo a visualização de vazamentos ou danos, devido a presença de um indicador químico colocado na parte externa da embalagem para o equipamento Sterrad 100S.	UNIDADE	100
2	Indicador biológico de leitura rápida; indicado para uso em equipamentos de esterilização por peróxido de hidrogênio. Caixa com 30 unidades. Contém uma fita de esporos de Geobacillus stearothermophilus [concentração de 10	UNIDADE	900

[Assinaturas manuscritas]

Recebido
18/12/19



	elevado a 6 (106) e valor D específico para o processo], uma ampola de meio de cultura específico para indicação de crescimento microbiano e enzima específica para leitura por fluorescência. A tampa do indicador contém indicador químico específico para o Sistema de Esterilização STERRAD®. Leitura realizada em 30 minutos de incubação. Possui informações de lote, validade e número sequencial (com código de barras) para facilitar o processo de leitura com leitora/incubadora própria, validado para o equipamento Sterrad.		
3	Indicador químico em rolo de 55 metros consiste em uma fita adesiva de um plástico tipo ABS contendo impressão na cor vermelha impregnada com reativos químicos que após a exposição ao peróxido de hidrogênio tem a sua cor alterada para laranja amarelada. Para uso exclusivo no Sistema de Esterilização, validado para o equipamento Sterrad.	UNIDADE	05
4	Indicador químico tira, consiste em uma fita plástica de poliestireno de cor branca, contendo em uma das extremidades uma coloração vermelha conseguida através de reativos químicos que em contato com o peróxido de hidrogênio passam para a cor amarelada. O controle visual de mudança de coloração também está presente em um dos lados da fita. Para uso exclusivo no sistema de esterilização, validado para o equipamento Sterrad.	UNIDADE	500
5	Embalagem na forma de rolo 250mm x 70m, composta de Tyvek 4057 B e filme de poliéster/polietileno com dupla selagem (10 mm), com indicativo de abertura, com impressão indicando uso específico por plasma de peróxido de hidrogênio, permitindo abertura asséptica sem	UNIDADE	25

[Handwritten signatures and initials]

16



<p>delaminação ou rasgos. Indicador químico impresso entre o filme e o Tyvek na cor vermelha intensa, a qual muda para laranja amarelado após processo de esterilização. A tinta presente no indicador químico não deve conter metais pesados em sua composição, devido ao efeito carcinogênico dessas substâncias (de acordo com norma ISO 11140-1). Todas as embalagens, independentemente dos tamanhos, devem estar contidas em caixas dispensadoras, as quais protejam os indicadores químicos dos efeitos da luz, durante a utilização, com tampas abre-fecha. Todas as embalagens devem ter sido validadas em ciclos fracionados de esterilização quanto à estabilidade e funcionalidade dos indicadores químicos (2 anos de validade pré-esterilização), à avaliação da eficácia da penetração do agente esterilizante, à manutenção da barreira microbiana e selagem e também à avaliação da biocompatibilidade e resistência da embalagem pré e pós esterilização, validado para o equipamento Sterrad 100S. Registro no MS.</p>		
---	--	--

Leandro Souza de Oliveira Gago
LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA GAGO - Cap
 Encarregado do Setor de Material

Roberto Adjálme Santos Junior
ROBERTO ADJALME SANTOS JUNIOR – 1º TEN
 Adj de Almoxarifado

Roberto Adjálme Santos Junior
Roberto Adjálme Santos Junior
 TEN OF L. DOT 011627279
 CRP-DE 1478
 Ministério da Defesa - EB



Parecer do Fiscal Administrativo

1. Realizar pesquisa de preço a fim de verificar os valores praticados no mercado;
2. Identificar a disponibilidade de recurso orçamentário; e,
3. Iniciar processo administrativo.

Rio de Janeiro, RJ, 08 de Dezembro de 2019.

FLÁVIO LINO DOS SANTOS – TC

Fiscal Administrativo

Despacho do Ordenador de Despesas

1. Autorizo o início do procedimento por Adesão em Ata de Registro de Preço
2. O Chefe da Seção de Aquisições e Licitações (SAL) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; e,
3. Empregar, para fins do preconizado no Art. 38 Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, o seguinte recurso:

Esfera	PTRES	Fonte	ND	PI	Subitem

4. Publicar em Boletim Administrativo o presente despacho.

Rio de Janeiro, RJ, 08 de Dezembro de 2019.

ALEXANDRE ARTHUR DE S COSTA – Cel

Ordenador de Despesas/ Diretor do Hospital.

Pedro Henrique Moreira do Couto
Cel Med

Substituto
SALC

DIEx nº 49-CME/Div Enf/HGeRJ
EB: 65344.004469/2019-91



Rio de Janeiro, RJ, 5 de dezembro de 2019.

Da Chefe da Central de Material Esterilizado
À Sra Chefe da Divisão de Enfermagem

Assunto: Aquisição de materiais de consumo para esterilizadora STERRAD

Anexo: INSUMOS_PARA_STERRAD_2


Remeto, em anexo, o pedido de material de consumo necessário para uso na esterilizadora STERRAD, por período de (03 três) meses.

Informo, ainda, que os referidos materiais constam no SISCOFIS, porém encontram-se sem estoque no almoxarifado.

MARIA DE LOURDES RODRIGUES RIBEIRO - SC
Chefe da Central de Material Esterilizado

**"CENTENÁRIO DA MISSÃO MILITAR FRANCESA NO BRASIL, 1919/1940: VETOR DE
PROFISSIONALIZAÇÃO EM NOSSO EXÉRCITO"**

INSUMOS PARA STERRAD



1	<p>Cassete de peróxido de hidrogênio. Os cassetes contém 10 ampolas plásticas internas. Cada ampola possui 1,8 ml de peróxido de hidrogênio a 58% cada ampola. A conformação do cassete permite a injeção automática do agente esterilizante no equipamento, bem como a leitura óptica a fim de verificar a validade do mesmo. Cada cassete é embalado individualmente permitindo a visualização de vazamentos ou danos, devido a presença de um indicador químico colocado na parte externa da embalagem para o equipamento Sterrad 100S.</p>	Und	100
2	<p>Indicador biológico de leitura rápida indicado para uso em equipamentos de esterilização por peróxido de hidrogênio. Caixa com 30 unidades. Contém uma fita de esporos de Geobacillus stearothermophilus [concentração de 10 elevado a 6 (10⁶) e valor D específico para o processo], uma ampola de meio de cultura específico para indicação de crescimento microbiano e enzima específica para leitura por fluorescência. A tampa do indicador contém indicador químico específico para o Sistema de Esterilização STERRAD®. Leitura realizada em 30 minutos de incubação. Possui informações de lote, validade e número sequencial (com código de barras) para facilitar o processo de leitura com leitora/incubadora própria, validado para o equipamento Sterrad.</p>	Und	900
3	<p>Indicador químico em rolo de 55 metros, consiste em uma fita adesiva de um plástico tipo ABS contendo impressão na cor vermelha impregnada com reativos químicos que após a exposição ao peróxido de hidrogênio tem a sua cor alterada para laranja amarelada. Para uso exclusivo no Sistema de Esterilização, validado para o equipamento Sterrad .</p>	Und	05
4	<p>Indicador químico tira, consiste em uma fita plástica de poliestireno de cor branca, contendo em uma das extremidades uma coloração vermelha conseguida através de reativos químicos que em contato como peróxido de hidrogênio passam para a cor amarelada. O controle visual de mudança de coloração também está presente em um dos lados da fita. Para uso exclusivo no sistema de esterilização, validado para o equipamento Sterrad .</p>	Und	500
	<p>Embalagem na forma de rolo 250mm x 70m, composta de Tyvek 4057 B e filme de poliéster/polietileno com dupla selagem (10 mm), com indicativo de abertura, com impressão indicando uso específico por plasma de peróxido de hidrogênio, permitindo abertura asséptica sem delaminação ou rasgos. Indicador químico impresso entre o filme e o Tyvek na cor vermelha intensa, o qual muda para laranja amarelado após processo de esterilização. A tinta presente no indicador químico não deve conter metais pesados em sua composição, devido ao efeito carcinogênico</p>		

*
[Handwritten signature]
 L



5	dessas substâncias (de acordo com norma ISO 11140-1). Todas as embalagens, independentemente dos tamanhos, devem estar contidas em caixas dispensadoras, as quais protejam os indicadores químicos dos efeitos da luz, durante a utilização, com tampas abre-fecha. Todas as embalagens devem ter sido validadas em ciclos fracionados de esterilização quanto à estabilidade e funcionalidade dos indicadores químicos (2 anos de validade pré-esterilização), à avaliação da eficácia da penetração do agente esterilizante, à manutenção da barreira microbiana e selagem e também à avaliação da biocompatibilidade e resistência da embalagem pré e pós esterilização, validado para o equipamento Sterrad 100S. Registro no MS.	Und	25
---	---	-----	----

[Handwritten signature]



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO**

2020-01-10
HGR/RJ
10
SALC

Rio de Janeiro-RJ, 10 de janeiro de 2020.

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

CNPJ – 50.247.071/0001-61

Telefone: (11) 2949-3404

E-mail: marcelo.carneiro@mogamibrasil.com

Solicito a possibilidade dessa empresa autorizar a utilização dos pregões abaixo, como UG não participante, de acordo com o que prescreve o Decreto 7.892/13:

PREGÃO: 63/2019


UASG: 150247 – COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA

Item	Quant	VI Unit R\$	VI Total R\$
11	100	770,00	77.000,00
16	25	1.005,00	25.125,00
18	900	60,00	54.000,00
19	500	1,50	750,00
20	5	180,00	900,00

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do Hospital Geral do Rio de Janeiro
Avenida Duque de Caxias, Nr 1.551 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2457-1707 – email: salchgerj@gmail.com



MOGAMI
ESPECIALISTA EM SAÚDE



São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

Ao
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
Seção de Aquisições, Licitações e Contratos.
salchgerj@gmail.com
Fone: (21) 2457-1707

Ref.: Adesão ao Pregão nº 063/2019 – UFBA– UASG 150247.

Em resposta a vossa solicitação, vimos pela presente, manifestar nossa concordância em fornecer a esse Hospital o produto constante do Pregão acima mencionado.

Item	Descrição	Qtde.	Vl. Unt:
11	Cassete para esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio: cassete para uso específico no esterilizador sterrad* 100 s, cada cassete contem 10 ampolas plásticas internas, com 1,8 ml de peróxido de hidrogênio a 58%. A conformação do cassete permite a injeção automática no equipamento, bem como a leitura óptica a fim de verificar a validade do mesmo. Cada cassete é embalado individualmente e traz na parte externa dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade e indicadores químicos, permitindo a visualização de vazamentos e/ou danos. Cód: 10113.	100 Unds.	R\$ 770,00
16	Embalagem sterrad rolo 250 mm x 70 m tyvek mylar c/indicador químico: embalagem composta de tyvek e filme poliéster/poliétileno com tripla selagem de aproximadamente 10 mm, contendo indicador químico específico para plasma de peróxido de hidrogênio, permitindo abertura asséptica sem delaminação ou rasgos. Acompanha certificado de validação para o processo de esterilização. Embalado em rolo com aproximadamente 250 mm de largura e 70 m de comprimento. Cód: 42425N.	25 rolos	R\$ 1.005,00
18	Indicador biológico auto-contido para plasma de peróxido de hidrogênio; em frasco ampola; contendo população mínima de 1.000.000 de esporos de geobacillus stearothermophilus; acondicionada em ampola plástica; transparente; com tampa ventilada e indicador químico na parte superior; etiqueta que muda de cor; quando exposto ao plasma de peróxido; tampa com etiqueta para rastreabilidade; código de barras que armazenam eletronicamente; ASP/STERRAD	900 Unds.	R\$ 60,00
19	Indicador químico esterilização em tiras sterrad 100 s: indicador químico utilizado para controle da eficácia do processo de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, em tira adesiva individual impregnada com reativos químicos que em contato com o peróxido de hidrogênio mudam de cor. Cód: 14100.	500 Unds.	R\$ 1,50




 Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
 ATA SRP
Ministério de Economia

Área de Trabalho: **Solicitação de Adesão**
03/02/2020 10:36:50

Gestão: Apoio A Solicitação nº 00017/2020 foi Incluída.

Licitação

Órgão: 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UASG Gerenciadora: 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA)

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | Nº da Licitação: 00063/2019 | Nº da IRP: 00069/2019 | Nº do Processo: 23066031752/19-7 | Compra Nacional: Sim | Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Solicitação | Itens | Ocorrências

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO (UASG Solicitante: 160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO)

Nº da Solicitação: 00017/2020 | Situação: Em Edição | * Nº do Processo de Compra: 7

*** Justificativa para Adesão**

Para atender as necessidades do Hospital Geral do Rio de Janeiro que no momento não possui ata de registro de preços disponível para o item. Este item encontra-se em processo de licitação, na fase de pesquisa de preços. Realizada pesquisa de preços entre as atas SRP disponíveis, verificou-se a vantajosidade desta adesão.

166 Caracteres Disponíveis

Pré-requisitos para adesão

- * Foi realizada ampla pesquisa de mercado e, quando couber, elaboradas as respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico ou planejamento da contratação? Sim Não
- * Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços? Sim Não
- * O local de entrega desejado para o item é igual ao informado no edital? Sim Não
- * O fornecedor está ciente e de acordo que o local de entrega desejado para o item é diferente do informado no edital? Sim Não

- 14 - consultoria
- 17 - medicina física
- 20 - medicina quimica fito oclonice
- 19 - medicina física
- 16 - medicina de emergência



SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais **ATA SRP** Ministério da Economia

Área de Trabalho
 Consultas Ambiente: PRODUÇÃO Adesão **Solicitação de Adesão** 07/02/2020 11:22:54

Gestão Licitação
 Apoio Orgão UASG Gerenciadora
 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
 Modalidade de Licitação Nº da Licitação Nº da IRP Nº do Processo Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
 Pregão Eletrônico 00063/2019 00069/2019 23066031752/19-7 Sim Não

Solicitação Itens Ocorrências
 Filtro
 Nº do Item Descrição do Item Fornecedor

5 adesão(ões) solicitada(s)

Item				Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Agão
363332 - Cassete				50.247.071/0001-61 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					100	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
11	420	Unidade	10/09/2020	1º ASP STERRAD	420	R\$ 770,0000	0 100				
442405 - Embalagem p, esterilização				50.247.071/0001-61 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					25	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
16	72	Rolo 70,00 M	10/09/2020	1º ASP STERRAD	72	R\$ 1.005,0000	0 25				
396174 - Indicador biológico				50.247.071/0001-61 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					900	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
18	960	Unidade	10/09/2020	1º ASP STERRAD	960	R\$ 60,0000	0 900				
396288 - Indicador químico				50.247.071/0001-61 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					500	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
19	20000	Unidade	10/09/2020	1º ASP STERRAD	20000	R\$ 1,5000	0 500				
396175 - Indicador químico				50.247.071/0001-61 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					5	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
20	91	Unidade	10/09/2020	1º ASP STERRAD	91	R\$ 180,0000	0 5				

5 registros encontrados, exibindo todos os registros.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML 1^oRM
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO**

ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

Atesto para fins de aquisição que a descrição do item abaixo especificado está compatível com o solicitado no DIEx nº 276 – Set Mat/ Div Adm/ HGERJ, e atende as necessidades do CME desta OMS.

- 1) Cassete de peróxido de hidrogênio Valor: R\$770,00

Descrição: Cassete, composição com indicador químico, características adicionais 58% de peróxido de hidrogênio, aplicação para esterilização por peróxido de hidrogênio, apresentação com ampolas plásticas, capacidade para 5 ciclos.

- 2) Indicador biológico de leitura rápida Valor: R\$60,00

Descrição: Indicador biológico, tipo segunda geração, apresentação autocontido, ampola com meio de cultura, espécie bacillus stearothermophilus, aplicação esterilização por peróxido de hidrogênio.

- 3) Indicador químico em rolo Valor: R\$180,00

Descrição: Indicador químico, classe i, tipo uso externo, apresentação fita adesiva, características adicionais para esterilização por peróxido de hidrogênio.

- 4) Indicador químico tira Valor: R\$1,50



Descrição: Indicador químico, classe i, tipo uso interno, apresentação tira plástica, características adicionais para esterilização por peróxido de hidrogênio.

- 5) Embalagem na forma de rolo 250mmX70m Valor: R\$1.005,00

Descrição: Embalagem p/ esterilização, material polietileno de alta densidade- pead, composição c/ filme polímero multilaminado, aplicação 1 p/ esterilização de h2o2, apresentação rolo, componentes adicionais termosselante, tamanho cerca de 20 cm, componentes c/ indicador químico, tipo uso único.


MARIA DE LOURDES RODRIGUES RIBEIRO - SC
Chefe da Central de Material Esterilizado

M^a de Lourdes R. Ribeiro
Chefe de Enfermagem-CME
COREN-RJ 30998



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Bahia
Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00063/2019 (SRP)

Às 14:53 horas do dia 05 de setembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. DEBORAH LANDULFO MEDRADO DE VINHAES TORR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23066031752/19-71, Pregão nº 00063/2019.

Resultado da Homologação

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor Estimado: R\$ 1.551.725,8800

Situação: Homologado

Adjudicado para: H STRATTNER E CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.591.309,1800 , com valor negociado a R\$ 1.340.681,7400 .

Itens do grupo:

- * 1 - ESTERILIZANTE QUÍMICO
- * 2 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 3 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 4 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 5 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 6 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 7 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 8 - INDICADOR BIOLÓGICO
- * 9 - INDICADOR QUÍMICO
- * 10 - INDICADOR QUÍMICO

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor Estimado: R\$ 1.667.559,1300


Situação: Homologado

Adjudicado para: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 928.170,0000 , com valor negociado a R\$ 855.825,6000 .

Itens do grupo:

- * 11 - CASSETE
- * 12 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 13 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 14 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 15 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 16 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 17 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
- * 18 - INDICADOR BIOLÓGICO

Adjudicado para: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.070,0000 negociado a R\$ 978,6700 e a quantidade de 140 Rolo 70,00 M .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/09/2019 10:06:48	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF:50.247.071/0001-61, Melhor lance : R\$ 1.070,0000, Valor Negociado : R\$ 978,6700
Homologado	05/09/2019 14:53:28	DEBORAH LANDULFO MEDRADO DE VINHAES TORR	

Item: 16 - GRUPO 2**Descrição:** EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO**Descrição Complementar:** EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 20 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 72**Valor Estimado:** R\$ 1.340,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Rolo 70,00 M**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.115,0000 , com valor negociado a R\$ 1.005,0000 e a quantidade de 72 Rolo 70,00 M .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/09/2019 10:06:48	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF:50.247.071/0001-61, Melhor lance : R\$ 1.115,0000, Valor Negociado : R\$ 1.005,0000
Homologado	05/09/2019 14:53:28	DEBORAH LANDULFO MEDRADO DE VINHAES TORR	



Item: 17 - GRUPO 2**Descrição:** EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO**Descrição Complementar:** EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 30 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 1.499,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Rolo 70,00 M**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.564,0000 , com valor negociado a R\$ 1.499,3300 e a quantidade de 60 Rolo 70,00 M .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/09/2019 10:06:48	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF:50.247.071/0001-61, Melhor lance : R\$ 1.564,0000, Valor Negociado : R\$ 1.499,3300
Homologado	05/09/2019 14:53:29	DEBORAH LANDULFO MEDRADO DE VINHAES TORR	

Item: 18 - GRUPO 2**Descrição:** INDICADOR BIOLÓGICO**Descrição Complementar:** INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO**Tratamento Diferenciado:** -



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Bahia
Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00063/2019 (SRP)

Às 14:53 horas do dia 05 de setembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. DEBORAH LANDULFO MEDRADO DE VINHAES TORR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23066031752/19-71, Pregão nº 00063/2019.

Resultado da Homologação

Item: 19 - GRUPO 2

Descrição: INDICADOR QUÍMICO

Descrição Complementar: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO INTERNO, APRESENTAÇÃO TIRA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20.000

Valor Estimado: R\$ 2,6600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,5000 e a quantidade de 20.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/09/2019 10:06:48	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF:50.247.071/0001-61, Melhor lance : R\$ 1,5000
Homologado	05/09/2019 14:53:30	DEBORAH LANDULFO MEDRADO DE VINHAES TORR	

Item: 20 - GRUPO 2

Descrição: INDICADOR QUÍMICO

Descrição Complementar: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO FITA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 91

Valor Estimado: R\$ 261,6700

Situação: Homologado


Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 190,0000 , com valor negociado a R\$ 180,0000 e a quantidade de 91 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/09/2019 10:06:48	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF:50.247.071/0001-61, Melhor lance : R\$ 190,0000, Valor Negociado : R\$ 180,0000
Homologado	05/09/2019 14:53:31	DEBORAH LANDULFO MEDRADO DE VINHAES TORR	



Relatório de Cotação: cotação rápida 463

Pesquisa realizada entre 13/02/2020 09:21:41 e 13/02/2020 09:21:21

Relatório gerado no dia 13/02/2020 09:22:02 (IP: 177.8.88.118)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) cassete	1	1 Unidade	896,18	R\$ 896,18

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA EDUCACAO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro	NºPregão:582019 UASG:155011	24/01/2020	R\$ 896,18



Valor Unitário R\$ 896,18


Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 896,18

Valor Global:	R\$ 896,18
----------------------	-------------------

Valor do item em relação ao total

● 1) cassete

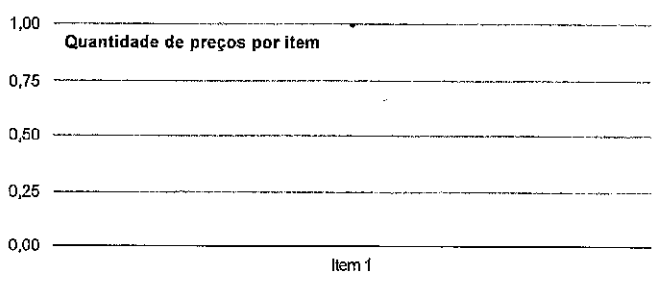



Relatório de Cotação: cotação rápida 464

Pesquisa realizada entre 13/02/2020 09:33:35 e 13/02/2020 09:33:07

Relatório gerado no dia 13/02/2020 09:34:03 (IP: 177.8.88.118)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) indicador digital de posicao	4	1 Unidade	1400,00	R\$ 1.400,00



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário Lauro Wanderley	Nº Pregão:32019 UASG:155023	02/04/2019	R\$ 1.400,00
Valor Unitário				R\$ 1.400,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.400,00

Valor Global: R\$ 1.400,00

Valor do item em relação ao total

● 1) indicador ...

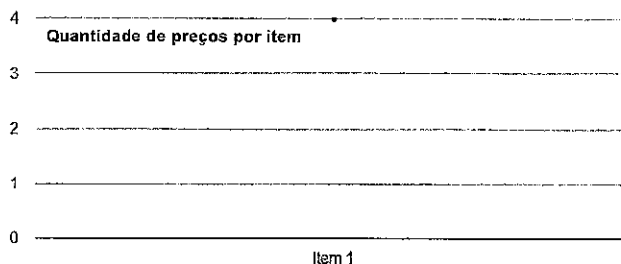

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 149,70	R\$ 180,40	R\$ 0,89

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 5 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO INTERNO, TIPO MONOPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO ROLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COMPONENTES ADICIONAIS USO INTERNO, INDICADOR QUÍMICO EM ROLO STERRAD, FITA INDICADOR QUÍMICO INTERNO, PREFERENCIALMENTE AUTO ADESIVO EM TIRA, PARA T ESTE DESAFIO, DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, MONITORANDO O LOTE A SER ESTERILIZADO, DEVE DEMONSTRAR MUDANÇA DE COR QUANDO EXPOSTO AO AGENTE ESTERILIZANTE, DURANTE A DIFUSÃO NO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. ROLO

Esfere

Federal

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2019

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Implantação de Registro de Preços para aquisições futuras e Materiais de consumo para Saúde: Para Máquina de Esterilização Sterrad 100S.

Quantidade Ofertada: 45

Valor Proposto Unitário: R\$255,30

Valor Unitário do Item: R\$ 255,00

Código do CATMAT: 354214

Descrição do Item: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE I, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MONOPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:ROLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COMPONENTES ADICIONAIS:USO INTERNO

Descrição Complementar: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO INTERNO, TIPO MONOPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO ROLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COMPONENTES ADICIONAIS USO INTERNO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JOHNSON & JOHNSON

Data do Resultado: 15/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ/CPF: 52202744000192


Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155019 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 20,91	R\$ 5,80	R\$ 0,42

Quantidade total de registros: 24

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição

INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: EXTERNO, APRESENTAÇÃO: TIRA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ORTOFTALALDEÍDO, APLICAÇÃO: P/ CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFETIVA (MEC) 0,55%

Esfera

Federal

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2019

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Implantação de Registro de Preços para aquisições futuras de materiais de consumo para Saúde: Antissépticos, Saneantes e outros;

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: R\$ 12,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,75

Código do CATMAT: 369467

Descrição do Item: INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: EXTERNO, APRESENTAÇÃO: TIRA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ORTOFTALALDEÍDO, APLICAÇÃO: P/ CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFETIVA (MEC) 0,55%

Descrição Complementar: INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO TIRA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ORTOFTALALDEÍDO, APLICAÇÃO P/ CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFETIVA (MEC) 0,55%

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JOHNSON & JOHNSON

Data do Resultado: 16/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ/CPF: 52202744000192


Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155019 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

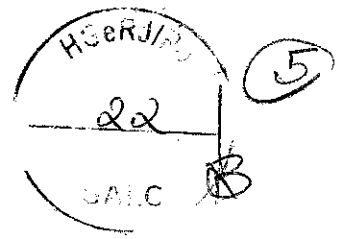

Relatório de Cotação: cotação rápida 466

Pesquisa realizada entre 19/02/2020 12:41:30 e 19/02/2020 12:40:52

Relatório gerado no dia 19/02/2020 12:41:50 (IP: 177.8.88.118)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) embalagem p/ esterilização	1	1 Unidade	1092,77	R\$ 1.092,77



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Complexo Hospitalar do Ceará	Nº Pregão: 192019 UASG: 155020	11/10/2019	R\$ 1.092,77
Valor Unitário				R\$ 1.092,77


Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.092,77

Valor Global:	R\$ 1.092,77
----------------------	---------------------

Valor do item em relação ao total

- 1) embalagem p/...

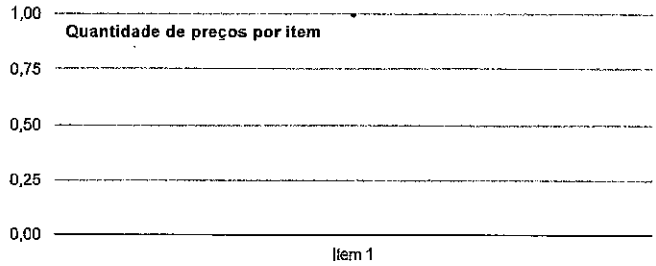



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.247.071/0001-61
Razão Social: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **01/05/2020**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/07/2020
FGTS	Validade:	11/03/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/08/2020


IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/04/2020
Receita Municipal	Validade:	25/03/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor


CNPJ: 50.247.071/0001-61
Razão Social: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução Total ou Parcial do Contrato**
UASG Sancionadora: **250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ**
Data Aplicação: **05/06/2014** Valor da Multa: **R\$ 3.244,80**
Número do Processo: **25410000932/2013**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa referente ao atraso na entrega do material solicitado no empenho 2013NE801156 - Pregão 317/2013 - Proc. 0932/13.**



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

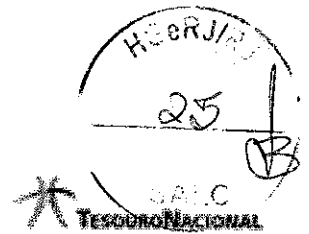

Data e hora da consulta: 19/02/2020 12:47:43

Usuário: 13846995703

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 50247071	Título: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

Código	Crédor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 50247071000161

LIMPAR




Data da consulta: 19/02/2020 12:47:42

Data da última atualização: 18/02/2020 18:00:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/02/2020 12:50:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
CNPJ: **50.247.071/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Hcerj/28
PAGINA: 13

EMISSAO : 19Fev20 NUMERO: 2020NE800099 ESPECIE: ORIGINAL
EMITENTE : 167323/00001 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ : 09616119/0002-49 FONE: (21) 2457-1700/(21) 2457-1705/(21) 2457-17
ENDERECO : AV. DUQUE DE CAXIAS, NR 1.551 VILA MILITAR
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21615-220

CREDOR : 50247071/0001-61 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ENDERECO : TAPECIMA 190 198 VILA CONSTANCA
MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 02256-020

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
NC400025 DE 14JAN20 EMT 167505 DGP - MAPA SIPEO NR 1- ATD DSP AQS MATERIAL
HOSPITALAR- PE63/2019 UASG 150247 REF AO DIEX NR 276 - SET MAT/DIV ADM/ HGERJ
DE 08DEZ19 DO ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL. PROC ORIGEM: 05000632019

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0250270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23066031752/19-71
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:


VALOR ORIGINAL : 157.775,00
CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 36 -MATERIAL HOSPITALAR
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 100 VALOR UNITARIO: 770,00
VALOR DO SEQ. : 77.000,00

100,00000 Unidade
CASSETE, COMPOSICAO COM INDICADOR QUIMICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 58 DE
PEROXIDO DE HIDROGENIO, APLICACAO PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE
HIDROGENIO, APRESENTACAO COM AMPOLAS PLASTICAS, CAPACIDADE PARA 5 CICLOS
MARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000363332

SUBTOTAL : 77.000,00



NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 52

EMISSAO : 19Fev20 NUMERO: 2020NE800099 PROCESSO: 23066031752/19-71
EMITENTE : 167323/00001 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
CREDOR : 50247071/0001-61 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 25 VALOR UNITARIO: 1.005,00
VALOR DO SEQ. : 25.125,00

25,00000 Rolo 70,00 M
EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD,
COMPOSICAO C/ FILME POLIMERO MULTILAMINADO, APLICACAO 1 P/ ESTERILIZACAO DE
H2O2, APRESENTACAO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA
DE 20 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUIMICO, TIPO USO USO UNICO
MARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00016 ITEM DE MATERIAL: 000442405

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 900 VALOR UNITARIO: 60,00
VALOR DO SEQ. : 54.000,00

900,00000 Unidade
INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERACAO, APRESENTACAO AUTOCONTIDO, AMPOLA
COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, APLICACAO
ESTERILIZACAO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
MARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00018 ITEM DE MATERIAL: 000396174

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 500 VALOR UNITARIO: 1,50
VALOR DO SEQ. : 750,00

500,00000 Unidade
INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO INTERNO, APRESENTACAO TIRA
PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZACAO POR PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO
MARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00019 ITEM DE MATERIAL: 000396288

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 5 VALOR UNITARIO: 180,00
VALOR DO SEQ. : 900,00

5,00000 Unidade
INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO EXTERNO, APRESENTACAO FITA
ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZACAO POR PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO
MARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00020 ITEM DE MATERIAL: 000396175

TOTAL : 157.775,00

Handwritten signature of Alberto Pereira Oliveira
ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

Handwritten signature of Gestor Financeiro
GESTOR FINANCEIRO

Handwritten signature and initials at the bottom right.

EMISSAO : 19Fev20 NUMERO: 2020NE800099 PROCESSO: 23066031752/19-71
EMITENTE : 167323/00001 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
CREDOR : 50247071/0001-61 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 25 VALOR UNITARIO: 1.005,00
VALOR DO SEQ. : 25.125,00

25,00000 Rolo 70,00 M
EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD,
COMPOSICAO C/ FILME POLIMERO MULTILAMINADO, APLICACAO 1 P/ ESTERILIZACAO DE
H2O2, APRESENTACAO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA
DE 20 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUIMICO, TIPO USO USO UNICO
MARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00016 ITEM DE MATERIAL: 000442405

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 900 VALOR UNITARIO: 60,00
VALOR DO SEQ. : 54.000,00

900,00000 Unidade
INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA
COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, APLICACAO
ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO
MARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00018 ITEM DE MATERIAL: 000396174

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 500 VALOR UNITARIO: 1,50
VALOR DO SEQ. : 750,00


500,00000 Unidade
INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO INTERNO, APRESENTAÇÃO TIRA
PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE
HIDROGENIO
MARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00019 ITEM DE MATERIAL: 000396288

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 5 VALOR UNITARIO: 180,00
VALOR DO SEQ. : 900,00

5,00000 Unidade
INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO FITA
ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE
HIDROGENIO
MARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00020 ITEM DE MATERIAL: 000396175

T O T A L : 157.775,00


ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO


NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 28Jul20 NUMERO: 2020NE000132
 ESPECIE : 01 - ORIGINAL
 EMITENTE : 167323/00001 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
 CNPJ : 09616119/0002-49 FONE: -(21) 2457-1700/(21) 2457-1705/(21) 2457-17
 ENDERECO : AV. DUQUE DE CAXIAS, NR 1.551 VILA MILITAR
 MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21615-220

CREDOR : 50247071/0001-61 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ENDERECO : TAPECIMA 190 198 VILA CONSTANCA
 MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 02256-020

TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 2020NC400025 DE 14JAN20/DGP - MAPA SIPEO NR 1- ATD DSP AQS MATERIAL
 HOSPITALAR- PE63/2019 UASG 150247 REF AO DIEX NR 276 - SET MAT/DIV ADM/ HGERJ
 DE 08DEZ19 DO ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL.

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0270270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: NAO SE APLICA
 AMPARO: INCISO: PROCESSO:
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA: NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 75.825,00
 SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 36 -MATERIAL HOSPITALAR
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 45 VALOR UNITARIO: 770,00
 VALOR DO SEQ. : 34.650,00

CASSETE, COMPOSICAO COM INDICADOR QUIMICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 58 DE
 PEROXIDO DE HIDROGENIO, APLICACAO PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE
 HIDROGENIO, APRESENTACAO COM AMPOLAS PLASTICAS, CAPACIDADE PARA 5 CICLOS
 MARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00011

SUBTOTAL : 34.650,00

MISSAO : 28Jul20 NUMERO: 2020NE000132 PROCESSO:
 MITENTE : 167323/00001 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
 REDOR : 50247071/0001-61 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

EQ.: 2 QUANTIDADE: 25 VALOR UNITARIO: 1.005,00
 VALOR DO SEQ. : 25.125,00

MBALAGEM P/ ESTERILIZACAO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD,
 COMPOSICAO C/ FILME POLIMERO MULTILAMINADO, APLICACAO 1 P/ ESTERILIZACAO DE
 202, APRESENTACAO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE
 20 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUIMICO, TIPO USO ÚNICO
 ARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00016

EQ.: 3 QUANTIDADE: 240 VALOR UNITARIO: 60,00
 VALOR DO SEQ. : 14.400,00

INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERACAO, APRESENTACAO AUTOCONTIDO, AMPOLA
 COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, APLICACAO
 ESTERILIZACAO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
 ARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00018

EQ.: 4 QUANTIDADE: 500 VALOR UNITARIO: 1,50
 VALOR DO SEQ. : 750,00

INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO INTERNO, APRESENTACAO TIRA
 LÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZACAO POR PERÓXIDO DE
 HIDROGÊNIO
 ARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00019

EQ.: 5 QUANTIDADE: 5 VALOR UNITARIO: 180,00
 VALOR DO SEQ. : 900,00

INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO EXTERNO, APRESENTACAO FITA
 DESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZACAO POR PERÓXIDO DE
 HIDROGÊNIO
 ARCA: ASP STERRAD ITEM DO PROCESSO: 00020

TOTAL : 75.825,00

Alberto Pereira Oliveira
 Ordenador
 IDT 919602823-7 MD/EF


ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
 ORDENADOR

Eduardo José da Silva Moraes
 GESTOR FINANCEIRO

Eduardo José da Silva MORAES
 1º TEN QAO SAU
 IDT 019602823-7 MD/EF



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, faço o encerramento do presente processo de adesão à ata de registro de preço, conforme a Portaria Nr 01 – SEF, de 27 de janeiro de 2014, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Fabiola A. B. de Souza Sestare

FABÍOLA APARECIDA BENTO DE SOUZA SESTARE – 3º SGT
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos